

# **Appareil de laboratoire**

## **Micro-centrifugeuse**

**Réf :  
701 578**

## 1. Description

Veillez lire attentivement le présent manuel avant toute utilisation et suivre toutes les consignes de sécurité et instructions de fonctionnement.




## 2. Spécifications

|                        |   |
|------------------------|---|
| Vitesse max. [tr/min]  | 7000  |
| FCR max. x g           | 2680  |
| Rotor                  | 1) 8 tubes de 0.5/1.5/2.0 ml<br>2) 16 tubes PCR de 0.2 ml, 2 barrettes de 8 tubes PCR de 0.2 ml |
| Mode de fonctionnement | Continu   |
| Moteur d'entraînement  | Moteur CC   |
| Puissance              | AC 100V~240V, 50Hz/60Hz   |
| Niveau de bruit        | ≤45 dB  |
| Dimensions [P×L×H mm]  | 150 x 150 x 117   |
| Poids [kg]             | 1   |

## 3. Chargement du Rotor

- Mettez le rotor en position sur l'arbre de moteur. Appuyez sur le rotor pour fixer le rotor à l'arbre.
- Utilisez vos deux mains pour charger le rotor.

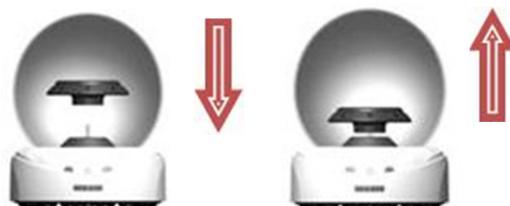

## 4. Fonctionnement

- Ouvrez le couvercle et appuyez sur l'interrupteur ON/OFF situé à l'arrière de l'unité.
- Chargez les tubes à centrifuger symétriquement dans le rotor.
- Fermez le couvercle de la centrifugeuse pour commencer à travailler.
- Eteignez l'appareil, le rotor s'arrêtera progressivement.
- Ouvrez le couvercle et ôtez les échantillons à l'arrêt complet du rotor.



## 5. Consignes de Sécurité

Les consignes détaillées décrites dans le Manuel de l'Utilisateur sont développées avec soin afin de tenter de répondre à tous les risques possibles. Veuillez les lire attentivement avant d'utiliser cette centrifugeuse.

- Assurez-vous que seul un personnel qualifié travaille avec l'appareil.
- N'utilisez jamais la centrifugeuse d'une façon non spécifiée dans les présentes instructions.
- Ne mettez jamais les mains dans la zone du rotor si celui-ci n'est pas à l'arrêt complet.
- Si une quelconque condition anormale se produit durant son utilisation, arrêtez immédiatement l'appareil et contactez notre service d'assistance technique.

## 6. Service après-vente

La garantie est de 2 ans, le matériel doit être retourné dans nos ateliers.

Pour toutes réparations, réglages ou pièces détachées, veuillez contacter :

**SAV – Le Laborantin**  
**468 rue Jacques Monod**  
**BP 1900**  
**27019 EVREUX CEDEX France**

**0 8256 888 111\***

*\* 0,15 € TTC/min. + prix appel*

